



## Soil DNA Isolation Kit

For genomic DNA purification from various soil samples as sludge, sandy soil, green garden, lawn grass, soil under palm tree and so on.

Research use only.

Store at room temperature.



## 目 录

产品介绍	3
产品特点	3
试剂盒应用	4
基因组DNA的应用	4
产品质量控制	4
试剂盒内容	5
产品信息	5
储存条件	5
试剂盒组分信息	6
注意事项	6
基因组DNA提取得率和纯度	7
基因组DNA片段大小	7
操作前准备事项	8
实验材料和设备	8
Lysozyme 溶液配制	8
安全性	8
操作指南	10
● 土壤基因组DNA提取操作步骤	10
DNA浓度及纯度测定	12
快速操作示意图	13
问题分析指南	14

## 产品介绍

本试剂盒提供了从各种来源的土壤中快速简便的提取基因组 DNA 的方法。土壤样品中存在大量的抑制因子如腐殖酸、金属离子等，这些物质即使微量存在于纯化后的 DNA 中也会对下游反应，如对 PCR、限制性酶切等产生影响。因而纯化土壤 DNA 的关键在于如何有效的去除土壤中的抑制因子。

采用本公司特有的 DNA-only 硅胶膜离心柱和溶液配方，搭配 Foregene Protease，可以有效的去除土壤中各种抑制因子，无需有机溶剂抽提或乙醇及异丙醇沉淀，在 90 分钟内即可完成对土壤样品中 DNA 的提取操作。

## 产品特点

- ◆ 无 RNA 酶污染：无需额外添加 RNA 酶即可去除基因组 DNA 中的 RNA，避免实验室遭受外源 RNA 酶污染。
- ◆ 速度快：操作简单，土壤基因组 DNA 提取操作在 90 分钟内即可完成。
- ◆ 方便：离心操作均在常温，无需 4°C 低温离心或乙醇沉淀 DNA。
- ◆ 安全：无需有机试剂抽提。
- ◆ 质量高：提取获得的基因组 DNA 片段大、无 RNA、无 RNA 酶、离子含量极低，能满足各种实验的要求。

## 试剂盒应用

该试剂盒适用于纯化以下样本基因组 DNA：淤泥样本、花坛土、踩地土、树林土、荒地土、池塘土、湖边土、草坪土等样本。

## 基因组 DNA 的应用

土壤基因组 DNA 提取试剂盒纯化获得的基因组 DNA 纯度高，可用于常规分子生物学操作，如：酶切、PCR、Southern 杂交、文库构建等实验。

## 产品质量控制

按照福际生物试剂盒质量检测体系标准(FOREGENE's Total Quality Management System)，每一批次的土壤基因组 DNA 提取试剂盒都严格进行多次测试，确保每一批次试剂盒质量的可靠性和稳定性。

## 试剂盒内容

Soil DNA Isolation Kit 土壤基因组 DNA 提取试剂盒					
试剂盒组成	DE-05511	DE-05512	DE-05513	DE-05514	DE-05515
	5 次	25 次	50 次	100 次	250 次
Buffer SG1	3.5ml	18ml	35ml	70ml	180ml
Buffer SG2	300µl	1.5ml	3ml	6ml	15ml
Buffer SG3	3.5ml	18ml	35ml	70ml	180ml
Buffer SG4	120µl	600µl	1.2ml	2.4ml	6ml
Buffer PW	3ml	15ml	30ml	60ml	150ml
Buffer WB	2.5ml	12.5ml	25ml	50ml	125ml
Buffer EB	1.5ml	6ml	15ml	60ml	120ml
Buffer TE	6ml	30ml	60ml	120ml	300ml
Foregene Protease	280µl	1.4ml	1.4ml×2	5.6ml	14ml
Lysozyme	50mg	250mg	500mg	500mg×2	500mg×5
离心柱	5 个	25 个	50 个	100 个	250 个
收集管	5 个	25 个	50 个	100 个	250 个
说明书	1 份	1 份	1 份	1 份	1 份

## 产品信息

型号	离心柱型	纯化组件	Foregene 离心柱、试剂
通量	1-24 个样品	制备时间	90min (24 个样品)
离心机	台式离心机	土壤酶解物分离	离心分离
离心柱液体盛装量	800µl	纯化柱 DNA 承载量	80µg
最小洗脱体积	100µl	土壤样本处理量	500mg

## 储存条件

- ◆ 本试剂盒在常温(15–25°C)干燥条件下，可保存 12 个月；如需保存更长时间可置于 2–8°C。

注意：若低温保存，溶液容易产生沉淀。在使用前务必将试剂盒内的溶液在室温中放置一段时间，必要时可在 37°C 水浴中预热 10 分钟，以溶解沉淀，混匀后再使用。

- ◆ Foregene Protease 溶液具有独特配方，常温保存长期（3 个月）具有活性；在 4°C 保存，其活性和稳定性会更好，因此建议将其置于 4°C 保存，切记不能置于 -20°C 保存。
- ◆ 干粉 Lysozyme -20°C 保存；配制好的 Lysozyme 溶液分成小份 -20°C 保存。

## 试剂盒组分信息

- ◆ Lysozyme: 酶解阳性菌细胞壁。
- ◆ Buffer TE: 用于配制 100mg/ml Lysozyme 的溶液和提供溶菌酶酶解环境。
- ◆ Buffer SG1 & Buffer SG2: 提供样本蛋白酶酶解环境。
- ◆ Foregene Protease: 在蛋白酶酶解环境下酶解组织样本，释放基因组 DNA。
- ◆ Buffer SG3: 失活 Foregene Protease，并提供 DNA 上柱环境。
- ◆ Buffer SG4: 补充提供 DNA 上柱环境。
- ◆ Buffer PW: 去除 DNA 中的蛋白质、RNA 等杂质。
- ◆ Buffer WB: 去除 DNA 中的残留的盐离子。
- ◆ Buffer EB: 洗脱纯化柱膜上的 DNA。
- ◆ DNA-only Column: 特异吸附裂解产物中的基因组 DNA。

## 注意事项 : ( 请务必在使用试剂盒前仔细阅读注意事项 )

- ◆ 每个土壤样本单次基因组 DNA 提取不宜超过 500mg。
- ◆ 试剂盒使用前，请务必检查 Buffer WB 是否按说明添加了无水乙醇。Buffer WB 在使用前分别添加 6ml 无水乙醇(DE-05511)、30ml 无水乙醇(DE-05512)、60ml 无水乙醇(DE-05513)、120ml 无水乙醇(DE-05514)、300ml 无水乙醇(DE-05515)。
- ◆ 使用前，仔细检查 Buffer SG2、Buffer SG3、Buffer SG4 和 Buffer PW 中是否有沉淀析出，若有沉淀析出，请将其置于 37°C 溶解，混匀后再使用。

- ◆ 在样品裂解过程中，应始终保持样品浸于裂解缓冲液中，若样品黏附在管盖及内壁，可通过短暂离心进行处理。
- ◆ 洗脱体积： Buffer EB 不应少于 100 $\mu$ l，否则会影响 DNA 产量。
- ◆ 切记不要在任何 Buffer 中添加 RNA 酶。
- ◆ 所有离心步骤均为使用台式离心机常温(15-25 $^{\circ}$ C)离心。
- ◆ 所有实验步骤均在常温(15-25 $^{\circ}$ C)进行。

## 基因组 DNA 提取得率和纯度

提取获得的土壤基因组 DNA 量与土壤样本的来源、存放时间、水分含量等因素相关。根据 Soil DNA Isolation Kit 处理各种来源土壤样本，获得的基因组 DNA 量和纯度见下表：


土壤来源	样本用量(mg)	DNA 产量( $\mu$ g)	OD260/280	OD260/230
花坛土	500	4-5	1.7-1.9	1.7-1.9
草地土(多石子)	500	4-6	1.7-1.9	1.8-1.9
树林土	500	4-6	1.7-1.9	1.7-1.8
草坪土	500	6-10	1.7-1.8	1.8-2.0
湖边	500	6-10	$\approx$ 1.8	1.9-2.0
松树林下	500	8-12	$\approx$ 1.8	1.8-1.9
池塘淤泥	500	6-8	1.7-1.8	1.7-1.8

注意：此表数据仅作参考，实际操作中由于所用材料的存储条件、操作熟练度等因素影响，所得数据会与此表数据有些许出入。

## 基因组 DNA 片段大小

土壤基因组 DNA 提取试剂盒是采用硅胶膜柱分离纯化土壤基因组 DNA，纯化获得的基因组 DNA 片段大小均在 23kb 附近。如图：

MspI - + - + - + - + - + - + - + - +



M 1 2 3 4 5 6 7 8

Soil DNA Isolation Kit 提取不同土壤样本DNA及其MspI酶切图

- : 未酶切土壤基因组DNA

+ : MspI酶切土壤基因组DNA

1: 花坛土 2: 菜地土 3: 树林土  
 4: 湖边土 5: 草坪土1 6: 草坪土2  
 7: 荒地土 8: 池塘土

(以上土壤样本取500mg, Soil DNA Isolation Kit提取DNA, 200 $\mu$ l洗脱液洗脱, 取8 $\mu$ l DNA 1%琼脂糖凝胶电泳)

## 操作前准备事项

使用本试剂盒前, 请务必仔细阅读说明书。土壤基因组 DNA 提取试剂盒操作简单、方便、快速, 说明书提供了整个试剂盒的完整信息和正确使用方法。请在使用前准备好必要的实验材料和设备。

## 实验材料和设备

- ◆ 各种来源的土壤样本 300-500mg。
- ◆ 1.5ml 或 2ml 无菌离心管。
- ◆ 无水乙醇。
- ◆ 台式离心机 ( $\geq 13,400\times g$ )、65 $^{\circ}$ C水浴或金属浴、移液器、涡旋仪等。

## Lysozyme 溶液配制

使用前, Lysozyme 配制成浓度为 100mg/ml 的溶液。Lysozyme 溶液避免反复冻融, 分装成小份后于-20 $^{\circ}$ C保存。使用前, 将 Lysozyme 溶液在室温下溶解, 每个样品用量为 100 $\mu$ l。

DE-05511	溶于 500 $\mu$ l Buffer TE
DE-05512	溶于 2.5ml Buffer TE
DE-05513	分别溶于 5ml Buffer TE
DE-05514	分别溶于 5ml Buffer TE
DE-05515	分别溶于 5ml Buffer TE



## 安全性

- ◆ 本产品仅供科研使用，请勿用于医药、临床医疗、食品及化妆品等用途。
- ◆ 使用化学品时，穿戴合适的实验服，手套，防护眼镜等。
- ◆ Buffer SG1、Buffer SG3、Buffer PW 含有胍盐：变性剂，刺激性。
- ◆ Buffer SG2 含有 SDS：刺激性，致敏性。
- ◆ Buffer WB 含无水乙醇：易燃。
- ◆ Foregene Protease：增敏剂，刺激性。

## 操作指南

土壤基因组 DNA 提取试剂盒提供了一种快速处理土壤样本,纯化基因组 DNA 的方法,请严格按照土壤基因组 DNA 提取操作步骤进行相关实验。

### 材料取用说明

各种来源的土壤, 单次处理的土壤样本不超过 500mg。

### 土壤基因组 DNA 提取操作步骤

**使用前请先在 Buffer WB 中加入无水乙醇, 加入体积请参照瓶上的标签。**

1. 称取 500mg 土壤样品, 置于 2ml 离心管中。

**注意:** 如果样本是悬浊液, 可 13,300rpm (17,000×g) 离心 1min, 收集沉淀后再称取 500mg 置于 2ml 离心管中。

2. 向离心管中加入 1ml Buffer TE、100µl Lysozyme (配制方法见第 8 页) 充分混匀后, 37°C 摇床温浴 30min (转速: 180rpm/min)。

3. 7,200rpm (~5,000×g) 离心 5min, 用移液器吸除上清。

**注意:** 应尽量吸净残留上清, 以免影响后续操作。

4. 向留有沉淀的离心管中加入 600µl Buffer SG1, 上下颠倒充分混匀, 加入 50µl Foregene Protease, 50µl Buffer SG2, 涡旋充分混匀。

**注意:** 使用前请检查 Buffer SG2 是否有沉淀产生, 如有沉淀产生, 请将溶液置于 65°C 温育, 直至沉淀溶解后使用。

5. 将离心管置于 65°C 水浴或金属浴 30min, 其间每隔 10min 上下颠倒充分混匀一次。

6. 向离心管中加入 600µl Buffer SG3, 上下颠倒充分混匀, 置于 65°C 水浴或金属浴 10min, 其间每隔 4min 上下颠倒充分混匀一次。

7. 12,000rpm (~13,400×g) 离心 5min, 用移液器将上清液转移至新的 2ml 离心管中, 应避免吸到沉淀。

8. 向离心管中加入 20µl Buffer SG4, 280µl 乙醇 (96-100%) 涡旋充分混匀 10sec, 可以瞬时离心收集附着在管盖和管壁的液滴。

9. 将离心柱放入收集管中, 取 800µl 混合液加入离心柱中, 12,000rpm (~13,400×g), 离心 1min。

10. 倒掉收集管中废液, 将离心柱放回收集管中, 将剩余混合液全部加入离心柱中,


- 12,000rpm(~13,400×g), 离心 1min。
11. 倒掉收集管中的废液, 将离心柱放回收集管中, 向离心柱中加入 500μl Buffer PW, 12,000rpm(~13,400×g), 离心 1min。
  12. 倒掉收集管中的废液, 将离心柱放回收集管中, 向离心柱中加入 700μl Buffer WB, 12,000rpm(~13,400×g), 离心 1min。
  13. 重复步骤 12 一次。
  14. 倒掉收集管中的废液, 将离心柱放回收集管中, 12,000rpm(~13,400×g)离心 1min。
  15. 将离心柱转移至新的 2ml 离心管中, 向膜中央悬空滴加 100μl 已于 65°C预热的 Buffer EB, 室温放置 5min, 12,000rpm(~13,400×g) 离心 1min。再次向膜中央悬空滴加 100μl 已预热的 Buffer EB, 12,000rpm(~13,400×g) 离心 1min。将两次收集的洗脱液合并。

注意: 如果希望提高 DNA 的浓度, 可将第 1 次离心得到的溶液重新加回离心柱中, 12,000rpm (~13,400×g) 离心 1min。

## DNA 浓度及纯度检测

- ◆ 得到的基因组 DNA 的质量与操作过程中的多种因素有关。DNA 可用琼脂糖凝胶电泳和紫外分光光度计检测浓度与纯度。
- ◆ DNA 的 OD260 值为 1 相当于大约 50 $\mu$ g/ml 双链 DNA。
- ◆ DNA 的 OD260/280 $\approx$ 1.7-1.9。如果洗脱时不使用洗脱缓冲液 Buffer EB，而使用去离子水，比值会偏低，因为 pH 值和离子存在会影响光吸收值，但并不表示纯度低。

## 快速操作示意图

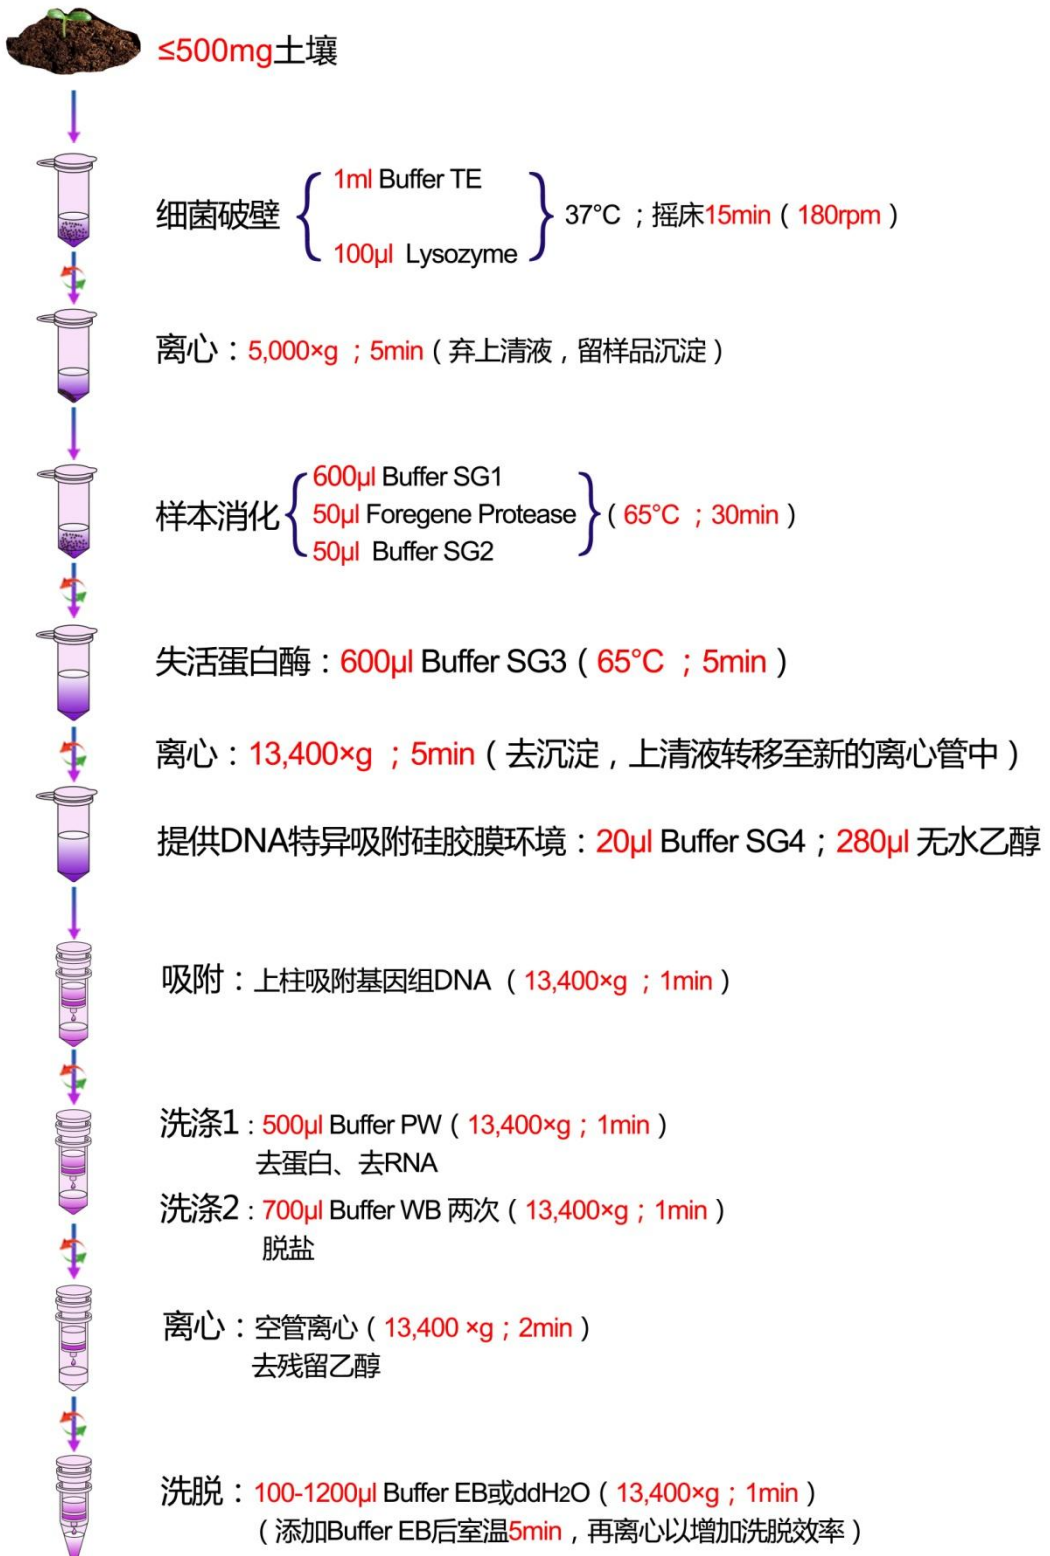

## 问题分析指南

以下针对土壤样本基因组 DNA 提取中可能遇到的问题进行分析，希望能对您的实验有所帮助。另外，对于在操作说明和问题分析以外的其他实验或技术上的问题，我们设有专门的技术支持帮助您。如有任何需要可联系我们：028-66070618 或 E-mail:

[Tech@foregene.com](mailto:Tech@foregene.com)。

### 低产量或无 DNA

通常有多种因素会影响基因组 DNA 产量，包括样本来源、样本保存条件、样本的预处理、操作等。

### 提取过程中无法获得基因组 DNA

1. 土壤样本保存不当或保存时间太长，导致土壤里面的菌落死亡，基因组 DNA 已经降解。

建议：土壤样本保存于-20°C或者-80°C；尽量采用新近采取的土壤样本进行基因组 DNA 的提取。

2. 土壤用量过少或者是特别贫瘠的荒地土。荒地土本身菌落含量很少，如果样本用量很少，可能导致提取不到相应的基因组 DNA。

建议：对于菌落含量较少的土壤样本，尽量使用 500mg 样本进行基因组 DNA 提取操作。

3. 试剂盒保存不当或存放时间太长，导致试剂盒里面某些组分失效。

建议：购置新的土壤基因组 DNA 提取试剂盒进行相关操作。

4. 洗脱液没有正确滴加到硅胶膜上。

建议：将 65°C 预热的洗脱液滴加到硅胶膜的正中间，并在室温放置 5 分钟增加洗脱效率。

### 提取获得低产量基因组 DNA

1. 土壤样本保存不当或保存时间太长，导致土壤里面大量的菌落死亡，基因组 DNA 降解。

2. 建议：土壤样本保存于-20°C或者-80°C；尽量采用新近采取的土壤样本进行基因组 DNA 的提取。

3. 土壤用量过少或者是特别贫瘠的荒地土。荒地土本身菌落含量很少，相应的量提取到的基因组 DNA 含量会较少。  
建议：对于菌落含量较少的土壤样本，尽量使用 500mg 样本进行基因组 DNA 提取操作。
4. 洗脱液问题  
建议：请使用 Buffer EB 进行洗脱；如果使用 ddH<sub>2</sub>O 或其他洗脱液，确认洗脱液的 pH 值在 7-8.5 之间。
5. 洗脱液没有正确滴加  
建议：请将洗脱液滴加到硅胶膜的正中间，并在室温放置 2 分钟增加洗脱效率。
6. 洗脱液体积太少  
建议：请按说明书上要求使用洗脱液进行基因组 DNA 洗脱，最少不要低于 100 $\mu$ l。

## 提取获得基因组 DNA 纯度低

基因组 DNA 纯度低会导致下游实验的失败或效果不理想，如：酶切不开，PCR 得不到目的基因片段等。

1. 样品裂解不充分  
分析：加入 Buffer SG1 后，没有充分混匀，使得裂解液和样品不能较好的反应。  
建议：务必按照说明书要求上下颠倒剧烈混匀 5sec，使得裂解液可以和样品充分接触，完成裂解。
2. 杂蛋白污染、RNA 污染  
分析：没有使用 Buffer PW 洗涤纯化柱；Buffer PW 洗涤纯化柱没有使用正确的离心转速。  
建议：在上清液过柱时尽量保证上清液中无沉淀；务必按说明书进行 Buffer PW 洗涤纯化柱，并且此步骤不能省略。
3. 杂质离子污染  
分析：省略了 Buffer WB 洗涤纯化柱或者只洗涤了一次，导致残留的离子污染。  
建议：务必按说明书使用 Buffer WB 洗涤 2 次，以尽量去除残留的离子。
4. RNA 酶污染  
分析：Buffer 中添加了外源的 RNA 酶；Buffer PW 洗涤操作不正确，导致 RNA 酶残留，影响下游 RNA 实验操作，如：体外转录等。  
建议：Foregene 系列核酸提取试剂盒无需额外添加 RNA 酶即可去除 RNA，Soil DNA Isolation Kit 里面所有试剂均无需添加 RNA 酶；务必按说明书进行 Buffer PW

洗涤纯化柱，并且此步骤不能省略。

#### 5. 乙醇残留

分析：**Buffer WB** 洗涤纯化柱后，没有进行空管离心操作。

建议：按说明书进行正确的空管离心操作。



中国·福际      World's Foregene

成都福际生物技术有限公司

电话: 028-83360257, 028-83361257

传真: 028-83361257

Email: [info@foregene.com](mailto:info@foregene.com)

Http://[www.foregene.com](http://www.foregene.com)

